

A Dentum rendszer felépítményeinek választéka


Implantátum átmérők (mm) és színekódjaik: 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0

	Felépítmény geometria megnevezés	Sulkus [mm]	Hossz [mm]
1	Zárócsavar	-	-
2	Ínyformázó fej, keskeny	2 4 6	
3	Ínyformázó fej, anatómiai	2 4 6	
4	Technikai implantátum		12
5	Mintavételi fej zárt kanálhoz		11
6	Mintavételi fej nyitott kanálhoz		11
7	Kiégethető fej, Co-Cr, fém alappal, pozicionált		12
8	Kiégethető fej, fém alappal, nem pozicionált		12
9	Interface, pozicionált	-	-
10	Interface, nem pozicionált	-	-
11	Gömbcsuklós fej, pozicionált	1 3	
12	Gömbcsuklós fej, nem pozicionált	1 3	
13	Ideiglenes fej, pozicionált		12
14	Ideiglenes fej, nem pozicionált		12
15	Ideiglenes fej, pozicionált, PEEK		12
16	Ideiglenes fej, nem pozicionált, PEEK		12
17	Keskeny fej, egyenes		9
18	Keskeny fej ferde, 15°, 25°		9
19	Univerzális fej, egyenes		11
20	Univerzális fej, ferde 15°, 25°, 35°, 45°		11
21	Anatómiai fej, egyenes	2 4 6	
22	Anatómiai fej, ferde 15°, 25°	2 4 6	
23	Trapéz fej 15°, 25°, 35°, 45°		9 11 13
24	Delta fej 15°, 25°, 35°, 45°		9 11 13
25	Titán bázis		5
26	Préskerámia alap		5
27	Csőfej, pozicionált		9
28	Csőfej, nem pozicionált		9
29	Titán bázis, PCT lépcsős		5
30	Scanbody fej, átmenőcsavaros		12
31	Scanbody fej, becsavarható		12
32	Gömbfej	0,5 1 2 3 4 5 6 7	
33	Lokátor fej, egyenes	0,5 1 2 3 4 5 6 7	
34	Multi-unit fej, egyenes	0,5 1 2 3 4 5 6 7	
35	Multi-unit fej, átmenőcsavaros	0,5 1 2 3 4 5 6 7	
36	Multi-unit fej ferde, 20°, 30°	1 2 3 4 5 6 7	
37	MC fej ferde, 20°, 30°	1 2 3 4 5 6 7	
38	Multi-unit SR fej, becsavarható	0,5 1 2 3 4 5 6 7	
39	Multi-unit SR fej, átmenőcsavaros	0,5 1 2 3 4 5 6 7	
40	Multi-unit SR fej, ferde 20°, 30°	1 2 3 4 5 6 7	
41	Oc fémsapka, OC műanyag betét; 1,8; 2,5	-	-
42	Lokátor sapka szett	-	-
43	Kiégethető műanyag fej, műanyag, Multi-unit	-	-
44	Kiégethető műanyag fej, Co-Cr, Multi-unit	-	-
45	Kiégethető műanyag fej, titán, Multi-unit	-	-
46	Kiégethető műanyag fej, Multi-unit SR	-	-
47	Kiégethető műanyag fej, Co-Cr, Multi-unit SR	-	-
48	Kiégethető műanyag fej, titán, Multi-unit SR	-	-

A méretek egyedi igényeknek megfelelően változhatnak

A Dentum rendszer funkcionális struktúrája

Implantátumainkhoz Grade 4, felépítményeinkhez Grade 5 minőségű titánt alkalmazunk. Felépítményeink készülhetnek továbbá Co-Cr anyagból, műanyag fejekhez pedig POM vagy PEEK anyagokat alkalmazunk.

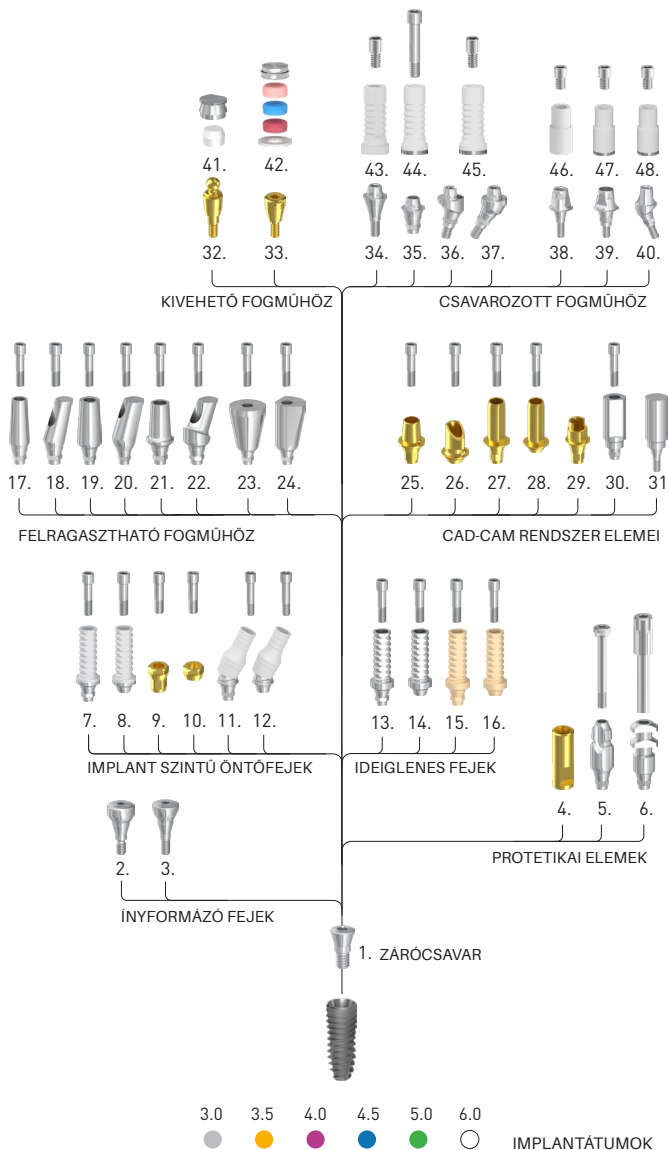

IMPLANTÁTUMOK



DENTUM

IMPLANT SYSTEM



BIONIKA Medline Kft • 3516 Miskolc, Tégla u. 29.
www.bionika.hu • info@bionika.hu
mobil: +36 70 670-6875

T-MD07-095-v01-220510-HU

CÉGISMERTETŐ

A BIONIKA Medline Kft. magyar családi vállalkozás, amit 1989-ben alapítottak magyar magánszemélyek.

Több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezünk az orvosi műszer és implantátum fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben.

A BIONIKA, mint kutató-fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt jelen van a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia és rehabilitáció orvos-szakmai területein.

Célkitűzésünknek és felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást jelöl a biológia, a technika és az elektronika határmezsgyéjén, amely ötvözi e három területet a kutató-fejlesztő munkánk során.


Klinikai és technológiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzájárul a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, ötvözése és hasznosítása a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos fejlesztés alatt tartunk.

Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termék és technológiai fejlesztésekre. Termékeinket orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú minőségét és gyakorlati használatosságát egyaránt.



Minőség: A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai Uniós jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel rendelkeznek.

Garancia: Az implantátum beültetést követően - a csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül - a vásárlást követő egy éven belül, cseregaranciát biztosítunk. Valamint termékeinkre hosszú távú, 10 éves garanciát adunk.

A Dentum rendszer jellegzetes tulajdonságai

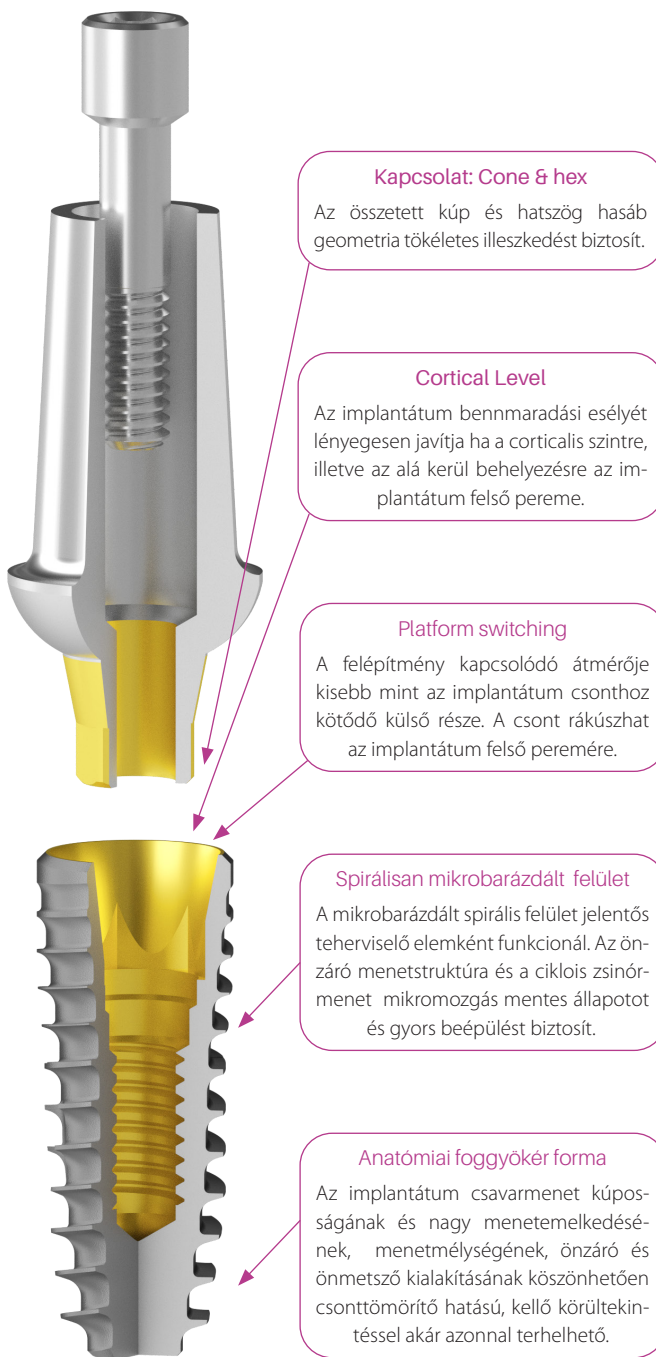

A Dentum Implantátumok méretválasztéka

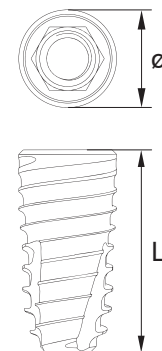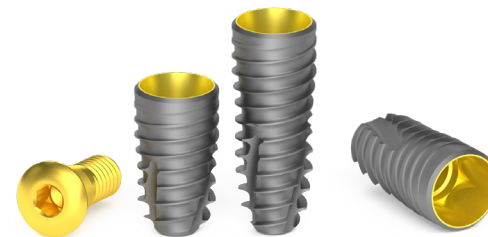

ø: átmérő (mm)	L: beültetési hossz (mm)					
	7	8	10	12	14	16
ø 3,0	●	●	●	●	●	
ø 3,5	●	●	●	●	●	●
ø 4,0	●	●	●	●	●	●
ø 4,5	●	●	●	●	●	●
ø 5,0	●	●	●	●		
ø 6,0	○	○	○			